

EVALUATION CONCERNANT L'APPLICATION DE LA PROCEDURE DE PREDESINFECTION DANS LES SERVICES DU CHIBT

Perriat Sophie, Guisset Claire, Garcia Valérie, Afifi Nanaz, Giraudon Laurent, Blondin Christine, Service Pharmacie et Stérilisation du CHIBT 34207Sète

INTRODUCTION:

Entre 2005 et 2007, l'ensemble des procédures et modes opératoires de la stérilisation ont été mis à jour et validés. Une nouvelle procédure concernant la pré-désinfection a été élaborée en collaboration avec le CLIN, suite à un audit interne réalisé en mai 2006 et diffusée dans tous les services concernés.

OBJECTIF:




Nous avons donc décidé d'évaluer le degré de connaissance et d'application de la nouvelle procédure, par un deuxième audit interne: analyse des résultats, évaluation des points forts et des points faibles, proposition d'amélioration et diffusion des résultats dans les services.

METHODE:

Un questionnaire comprenant 28 items a été élaboré à partir de cette nouvelle procédure afin d'évaluer l'impact des mesures correctives mises en place et leur applicabilité: tenue, trempage, rinçage, séchage, stockage, transport. 15 services ont été audités (réanimation, urgences, médecine, cardiologie, consultations, pédiatrie, bloc gynécologie, maternité, radiologie, chirurgie polyvalente) un jour donné en janvier 2007 par deux internes en pharmacie et la préparatrice responsable de la stérilisation

RESULTATS:

Les 21 personnes auditées (7 infirmières, 11 AS, 1 assistante de puériculture, 2 manipulateurs en radiologie) connaissent toutes l'existence de cette procédure, celle-ci étant affichée dans 66% des services interrogés.

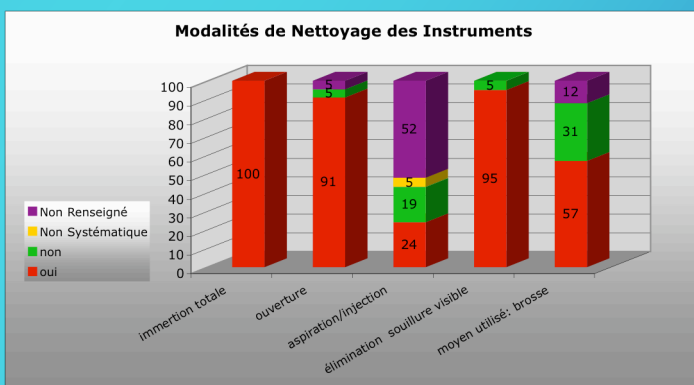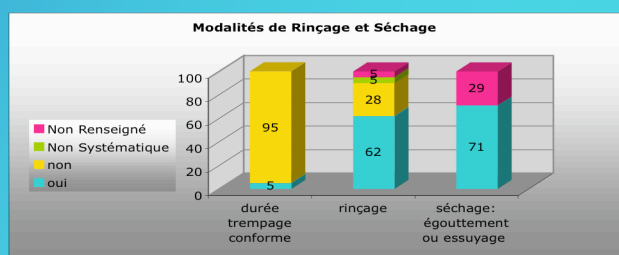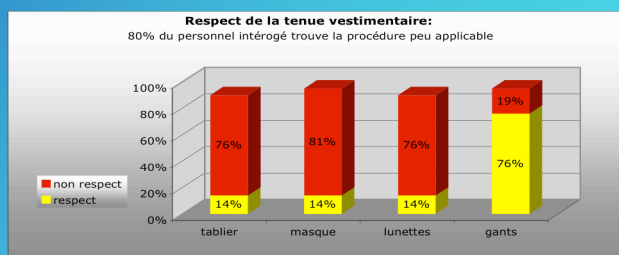

Les recommandations relatives au transport sont respectées: 95% des retours se font dans des bacs spécifiques

DISCUSSION/CONCLUSION:

✓ La mise en place de la nouvelle procédure a pour conséquences:

- Une sensibilisation du personnel à la nécessité de cette pré-désinfection pour limiter le risque infectieux puisqu'elle est majoritairement connue.
- Un trempage correctement réalisé, sans risque d'altération du matériel malgré une durée trop longue,
- Un rinçage du matériel beaucoup plus important (+35%) par rapport à l'audit mené en mai 2006.
- Des modalités de retour du matériel à stériliser maîtrisées et convenant à tous les services

Dans la pratique, le personnel audité effectue en général un pré-nettoyage en cas de souillures importantes mais le renouvellement de la solution de trempage en cas de souillures n'est que très rarement observé. La nécessité d'un personnel référent au sein du service qui aurait en charge la pré-désinfection a été évoquée plusieurs fois par le personnel audité.

✓ Les résultats obtenus ont été présentés au CLIN et par ce biais diffusés à l'ensemble des services. Les propositions d'amélioration suivantes peuvent être envisagées: nécessité de re-sensibiliser les différents acteurs concernant le rinçage, la durée de trempage, l'importance de la tenue et l'affichage systématique de la procédure dans tous les services